

FORMULAIRE CHAISE DE TRANSFERT COULISSANTE



☐ [CT-2413] CHAISE DE TRANSFERT COULISSANTE À BASCULE

☐ [CT-2513] CHAISE DE TRANSFERT COULISSANTE STANDARD


ERGO	BÉNÉFICIAIRE
CLSC :	Nom :
Nom :	Prénom :
Prénom :	Tél. :
Tél. :	Adresse :
Courriel :	
REPRÉSENTANT	
Nom complet :	

Montréal : 450-504-9961
Extérieur : 1-877-633-4209
1-877-MEDIC09
969 rue Lamontagne
St-Jérôme, Qc, J5L 1T8

OPTIONS

- ☐ Appui-tête [OP-3019]
- ☐ Appui-thoracique [OP-3021]
- ☐ Appui-pied de fauteuil roulant [OP-3025]
- ☐ Ceinture avec velcro [OP-3040]
- ☐ Ceinture avec boucle [OP-3037]
- ☐ Sceau en plastique [OP-3043]
- ☐ Anti-éclaboussure [OP-3033]
- ☐ Appui-bras en U [OP-3030]
- ☐ Dossier en toile pour chaise standard CP-2513 [OP-3045]
- ☐ Dossier en toile pour chaise à bascule CP-2413 [OP-3045]

Date : _____ Représentant : _____ Ergothérapeute : _____

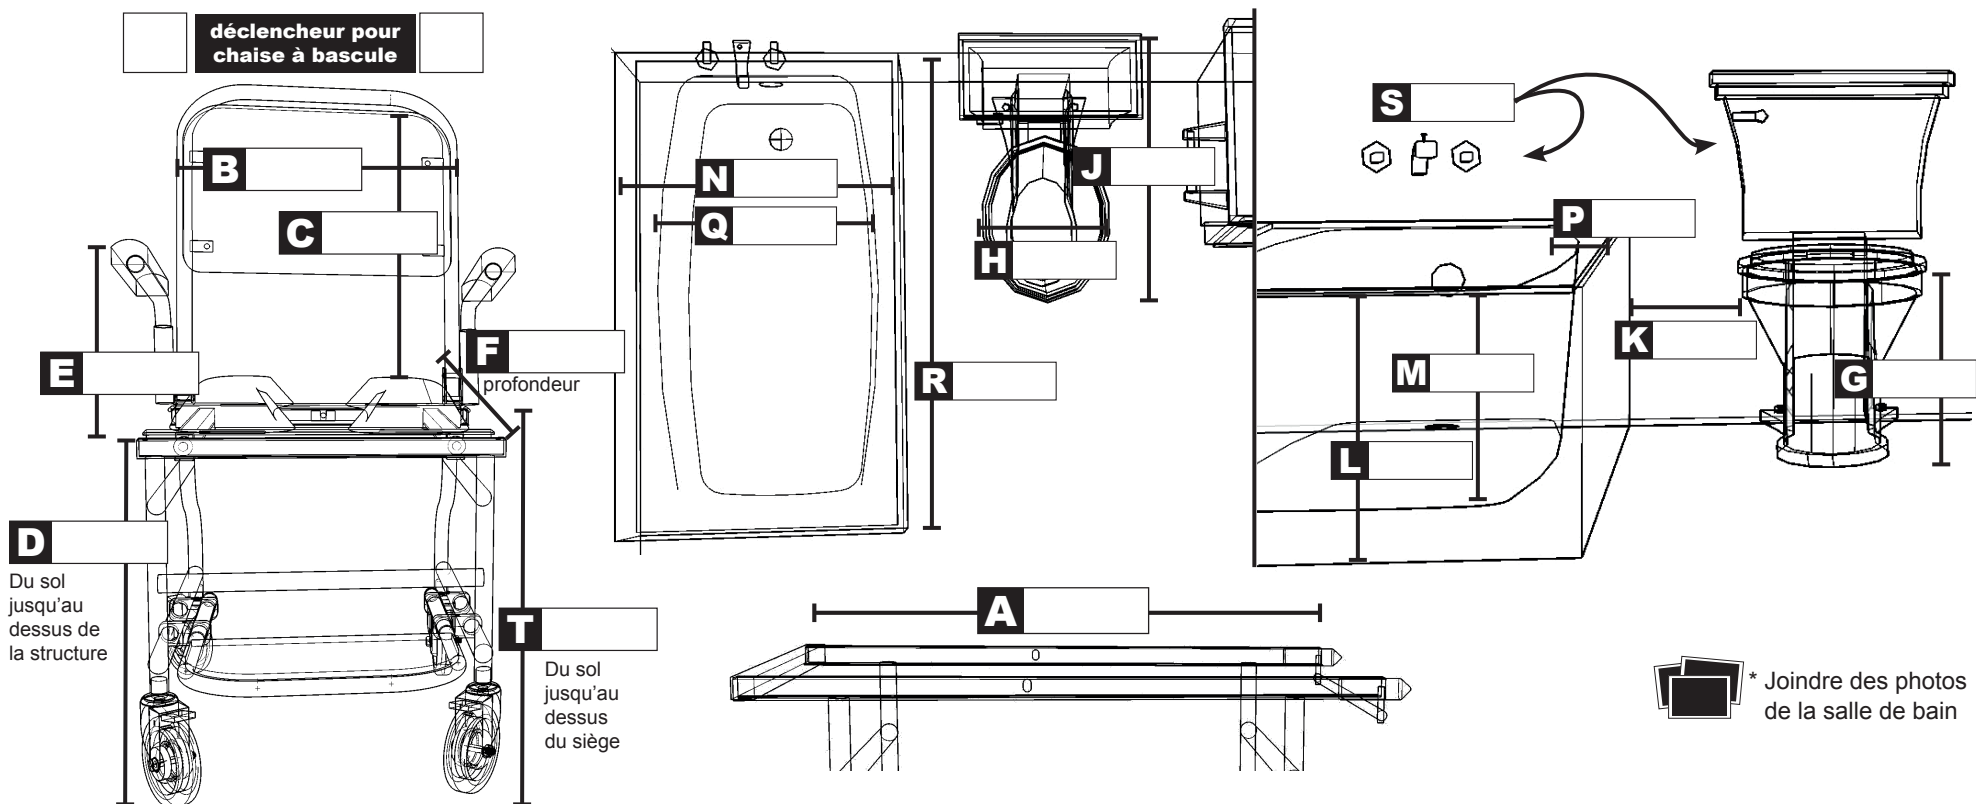

REF.	DESCRIPTION	DIMENSION	MODIFICATION	DÉTAILS ET NOTES
A	Longueur du pont	30"		
B	Largeur du dossier	19"		
C	Hauteur du dossier	20"		
D	Hauteur de la base de chaise	20"		
E	Hauteur de l'appui-bras en L	9"		
F	Profondeur de l'assise	à bascule : 19" standard : 21"		

MESURES IMPORTANTES À PRENDRE ET MODIFICATIONS SPÉCIALES

G	Hauteur de la toilette	M	Hauteur intérieur du bord du bain	S	Installation ☐ dos à la robinetterie ☐ face à la robinetterie
H	Largeur de la toilette	N	Largeur du mur au bord extérieur du bain		
J	Profondeur de la toilette	P	Épaisseur du bord du bain		
K	Distance entre le bain et la toilette	Q	Largeur intérieur du bain	T	Hauteur du sol jusqu'au dessus du siège
L	Hauteur extérieur du bord du bain	R	Profondeur de la salle de bain		

Les mesures ont été vérifiées et je me porte garant des dimensions

Date : _____ Représentant : _____ Ergothérapeute : _____